



MA CP100B-XX\_CP100R-XX\_CP103R-XX\_CP104-XX\_CP105-XX\_CP500B-XX\_CP500R-XX\_CP505-XX 02\_A\_ESP\_06-2022

## **SILLAS DE RUEDAS ARDEA ONE**

---

### **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

## ÍNDICE

<b>1. CÓDIGOS.....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>2. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>3. FINALIDAD.....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....</b>	<b>PAG.3</b>
<b>5. ADVERTENCIAS GENERALES.....</b>	<b>PAG.4</b>
<b>6. SÍMBOLOS.....</b>	<b>PAG.4</b>
<b>7. DESCRIPCIÓN GENERAL.....</b>	<b>PAG.5</b>
7.1 Vista y lista de las partes.....	pag. 5
<b>8. MONTAJE/DESMONTAJE.....</b>	<b>PAG.5</b>
8.1 Apertura.....	pag. 5
8.2 Cierre.....	pag. 6
8.3 Montaje/desmontaje de los brazos.....	pag. 6
8.4 Montaje/desmontaje de los estribos laterales o elevables.....	pag. 6
8.5 Regulación de los estribos laterales.....	pag. 7
8.6 Regulación de los estribos elevables (OPCIÓN).....	pag. 7
8.7 Montaje/desmontaje de las ruedas traseras pequeñas (sólo para GO!).....	pag. 7
8.8 Regulación de los frenos con ruedas traseras pequeñas (sólo para GO!).....	pag. 8
8.9 Montaje/desmontaje de las ruedas traseras grandes (sólo para START/START2 y START3).....	pag. 8
8.10 Regulación de los frenos con ruedas traseras grandes (solo para START/START2 y START3).....	pag. 8
<b>9. ANTES DE CADA USO.....</b>	<b>PAG.9</b>
<b>10. ADVERTENCIAS PARA EL USO.....</b>	<b>PAG.9</b>
<b>11. MODO DE USO.....</b>	<b>PAG.9</b>
11.1 Subirse a la silla de ruedas.....	pag. 9
11.2 Bajarse de la silla de ruedas.....	pag. 9
11.3 Escalones y desniveles (consejos para afrontarlos lo mejor posible estando solos).....	pag. 9
11.4 Uso de los brazos.....	pag. 10
11.5 Uso de las ruedas con auto-empuje.....	pag. 10
11.6 Uso de las ruedas pequeñas.....	pag. 10
11.7 Uso de las ruedas pequeñas para pasos angostos (de serie en los modelos con desenganche rápido).....	pag. 10
11.8 Transporte en medios de desplazamiento.....	pag. 10
<b>12. MANTENIMIENTO.....</b>	<b>PAG.11</b>
<b>13. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.....</b>	<b>PAG.11</b>
13.1 Limpieza del revestimiento y el relleno.....	pag. 11
13.2 Limpieza del bastidor y de las partes metálicas.....	pag. 11
13.3 Limpieza de las ruedas y de los frenos.....	pag. 11
13.4 Desinfección.....	pag. 11
<b>14. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN.....</b>	<b>PAG.11</b>
<b>15. REPUESTOS Y ACCESORIOS.....</b>	<b>PAG.11</b>
<b>16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....</b>	<b>PAG.12</b>
16.1 Medidas.....	pag. 12
16.2 Especificaciones técnicas.....	pag. 13
<b>17. GARANTÍA.....</b>	<b>PAG.13</b>
17.1 Reparaciones.....	pag. 13
17.2 Repuestos.....	pag. 14
17.3 Cláusulas exonerativas.....	pag. 14

**CE** Producto sanitario de clase I  
REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL  
CONSEJO del 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios

## 1. CÓDIGOS

<b>CP100B-xx</b>	Serie <b>START</b> ruedas 60 cm - <b>Plegable auto-empuje</b>
<b>CP100R-xx</b>	Serie <b>START</b> ruedas 60 cm - <b>Plegable auto-empuje</b>
<b>CP103R-xx</b>	Serie <b>START2</b> ruedas 60 cm - <b>Plegable auto-empuje</b>
<b>CP104-xx</b>	Serie <b>START3</b> ruedas 60 cm - <b>Plegable, auto-empuje, cruceta doble, agujero doble</b>
<b>CP105-xx</b>	Serie <b>START3 GO!</b> ruedas 30 cm - <b>Plegable, auto-empuje, cruceta doble, agujero doble</b>
<b>CP500B-xx</b>	Serie <b>GO!</b> ruedas 30 cm - <b>Plegable tránsito</b>
<b>CP500R-xx</b>	Serie <b>GO!</b> ruedas 30 cm - <b>Plegable tránsito</b>
<b>CP505-xx</b>	Serie <b>GO!2</b> ruedas 30 cm - <b>Plegable tránsito, cruceta doble</b>

(R = Rojo; B = Azul; xx = Indica las medidas del asiento disponible ej. 40-43-45-48-50 cm, 38 y 46 cm sólo para el color azul)

## 2. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido la silla de ruedas **ARDEA ONE** fabricada por MORETTI S.p.A., realizada para desplazar a personas con dificultades de movimiento dentro y fuera de casa, durante viajes o en las actividades cotidianas. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido así como valiosos consejos para su seguridad. Se aconseja leer atentamente todo el manual antes de utilizar la silla de ruedas. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

**Nota:** Comprobar que ninguna de las partes de la silla de ruedas haya sufrido daños durante el transporte. En caso de daños, no utilizar el producto y contactar con el revendedor para más instrucciones.

## 3. FINALIDAD

Esta silla de ruedas está destinada al desplazamiento de personas con dificultades motoras y puede utilizarse con auto-empuje (si está dotada de ruedas traseras grandes) o con la ayuda de un operador.

En todo caso es necesaria la intervención de un operador para las distintas regulaciones.

### ¡ATENCIÓN!



- Está prohibido utilizar el producto con fines diferentes de aquel definido en este manual.
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad respecto de los daños derivados de un uso incorrecto del producto o diferente de aquel indicado en el presente manual.
- El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto y a este manual sin aviso previo, con propósitos de mejora.

## 4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

MORETTI SpA declara bajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI S.p.A. y que forman parte de la familia de las SILLAS DE RUEDAS ARDEA ONE son conformes con las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 de abril de 2017.

Para ello, MORETTI SpA garantiza y declara bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestión cumplen con los requisitos generales de seguridad y prestación establecidos por el anexo I y el anexo IV del reglamento 2017/745.
2. Los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
3. Los productos en cuestión NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación NO ESTÉRIL.
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI SpA mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del último lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el reglamento 2017/745.

**Nota:** Los códigos completos de producto, el código de registro del fabricante (SRN), el código UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas figuran en la Declaración de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y pone a disposición a través de sus propios canales.

## 5. ADVERTENCIAS GENERALES

- Para el uso correcto del producto, leer atentamente el siguiente manual.
- Para el uso correcto del producto, consultar al médico o terapeuta.
- Mantener el producto embalado lejos de cualquier fuente de calor, ya que el embalaje es de cartón.
- La vida útil del producto depende del desgaste de las partes no reparables o sustituibles.
- Prestar siempre mucha atención a la presencia de partes móviles que podrían atrapar las manos y causar lesiones personales.
- Prestar atención especialmente si hay niños presentes.
- Para levantar correctamente la silla de ruedas es necesario cerrarla siguiendo las instrucciones de este manual y luego aferrarla por los asideros.
- No levantar la silla cómoda por sus partes móviles (brazos, respaldo, etc.), ya que podrían accidentalmente desprenderse.
- El usuario o paciente deberá señalar cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto al fabricante y a la autoridad competente del país miembro donde se encuentre.

## 6. SÍMBOLOS

	Código producto
	Identificación unívoca de productos
	Número de serie
	Marcado CE
	Fabricante
	Lote de producción
	Leer el manual de instrucciones
	Producto sanitario
	Condiciones de eliminación
	Peso máximo de carga


## 7. DESCRIPCIÓN GENERAL

### 7.1 Vista y lista de las partes


Según el modelo elegido, los elementos que componen la silla de ruedas son los siguientes:




A - Bastidor base de la silla de ruedas  
B - Juego de llaves para el ensamblaje

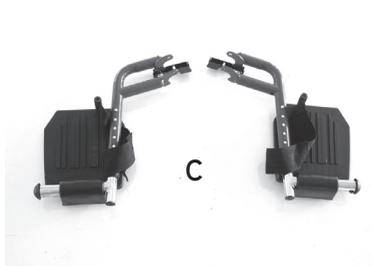

C - Estribos laterales

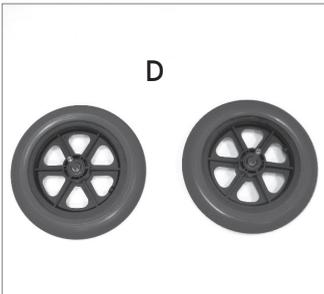

D - Ruedas traseras pequeñas  
(diámetro 30 cm) modelo tránsito

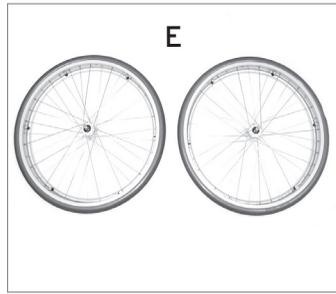

E - Ruedas traseras grandes  
(diámetro 60 cm) modelo auto-empuje

## 8. MONTAJE/DESMONTAJE

### 8.1 Apertura



(FIG.1)

**Nota:** Consultar las advertencias de seguridad este manual de instrucciones.

- Aferrar los tubos de los asideros y tirar hacia el exterior presionando el asiento hacia abajo y prestando atención para mantener la silla totalmente abierta (FIG.1)

## 8.2 Cierre



- Levantar enérgicamente el asiento y cerrar la silla de ruedas acercando los dos asideros de empuje (FIG.2)

## 8.3 Montaje/desmontaje de los brazos

CP100B-xx / CP100R-xx / CP103R-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500B-xx / CP500R-xx / CP505-xx



Imágenes ilustrativas


- Enganchar los brazos en el soporte posterior, volcarlos hacia delante y engancharlos en el soporte delantero (FIG.3)
- Para el desmontaje, presionar la palanca de desenganche delantera, volcar hacia atrás los brazos y tirar del pomo de desenganche posterior para extraerlos (FIG.4)

## 8.4 Montaje/desmontaje de los estribos laterales o elevables



- Para instalar los estribos laterales y elevables, alinear los orificios de los soportes con los pernos sobre el bastidor de la silla de ruedas, y girar el estribo hacia el interior engancharlo correctamente la palanca de bloqueo en el bastidor de la silla de ruedas (FIG.5)
- Para el desmontaje, desenganchar del bastidor la palanca del estribo, girarla hacia el exterior y extraerla hacia arriba

### 8.5 Regulación de los estribos laterales

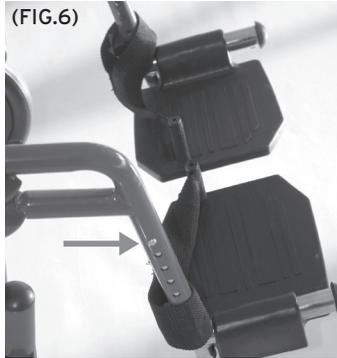

- Para regular la longitud de los estribos, desbloquear la palanca de seguridad izquierda situada en la parte inferior, presionar el pulsador con resorte, y desplazar el tubo del estribo hasta introducir nuevamente el pulsador en el orificio a la altura deseada. Bloquear nuevamente la palanca de seguridad. (FIG.6)

### 8.6 Regulación de los estribos elevables (OPCIÓN)



- Para regular la longitud de los estribos, desbloquear la palanca de seguridad izquierda situada en la parte inferior, presionar el pulsador con resorte, y desplazar el tubo del estribo hasta introducir nuevamente el pulsador en el orificio a la altura deseada. Bloquear nuevamente la palanca de seguridad. FIG.7 (ref.P)
- Para regular la inclinación de los estribos, accionar la palanca evidenciada en la FIG.7 (ref.L) y, una vez hallada la regulación adecuada, soltar la palanca para bloquear definitivamente los estribos.

### 8.7 Montaje/desmontaje de las ruedas traseras pequeñas (sólo para GO!)

Las ruedas traseras de 30 cm de diámetro se deben poner en el último orificio en la parte inferior del bastidor



#### Ruedas con perno fijo (sólo para GO!)

- Colocar la rueda pequeña y bloquearla con la tuerca en dotación
- Para el desmontaje, desenroscar la tuerca de fijación y extraer la rueda tirando hacia el exterior

Imagen ilustrativa

### 8.8 Regulación de los frenos con ruedas traseras pequeñas (sólo para GO!)



(FIG.9) Imagen ilustrativa

- Con las ruedas traseras de 30 cm de diámetro, el freno se debe poner en la parte grafilada del bastidor como se ve en la (FIG.9)

**Nota:** regular la distancia de la zapata a la rueda de modo que cuando el freno se accione pueda ejercer una presión que bloquee la rueda con seguridad.

### 8.9 Montaje/desmontaje de las ruedas traseras grandes (sólo para START/START2 y START3)

Las ruedas traseras de 60 cm de diámetro se deben poner en el orificio central en el bastidor, y en el orificio superior entre los 2 que se encuentran en la START3 (CP104-xx)



(FIG.10)

#### En caso de ruedas con desenganche rápido (sólo para START2 y START3)

- Quitar los tapones de plástico del orificio y colocar las ruedas presionando hacia el bastidor hasta encastrar correctamente el dispositivo de bloqueo automático (FIG.10)
- Para el desmontaje, presionar el pulsador en el centro de la llanta de la rueda con el fin de soltar el bloqueo, y extraer la rueda hacia el exterior (FIG.10)

#### En caso de ruedas con perno fijo (sólo para START)

- Colocar la rueda grande y bloquearla con la tuerca en dotación
- Para el desmontaje, desenroscar la tuerca de fijación y extraer la rueda tirando hacia el exterior

### 8.10 Regulación de los frenos con ruedas traseras grandes (solo para START/START2 y START3)



(FIG.11)

- Con las ruedas traseras de 60 cm de diámetro, el freno se debe poner en la parte grafilada del bastidor como se ve en la (FIG.11), bloqueando la zapata del freno mediante los dos tornillos Allen en el soporte

**Nota:** Regular la distancia de la zapata a la rueda de modo que cuando el freno se accione pueda ejercer una presión que bloquee la rueda con seguridad.

## 9. ANTES DE CADA USO

- Verificar siempre el desgaste de las partes mecánicas para garantizar el uso seguro del producto, libre de peligros para personas y bienes
- Verificar el correcto ensamblaje del dispositivo prestando atención a la correcta colocación y bloqueo de las ruedas traseras
- Comprobar que el asiento esté totalmente abierto en posición final de bloqueo (en caso contrario, presionar el asiento con fuerza verticalmente hacia el bastidor)
- Verificar el correcto funcionamiento del freno sobre las ruedas traseras

## 10. ADVERTENCIAS PARA EL USO

- La silla de ruedas no se puede utilizar como asiento en vehículos motorizados
- Asegurarse siempre de que el mando del freno esté bien regulado y en buenas condiciones de funcionamiento
- Se recomienda prestar atención para evitar que los dedos queden atrapados por partes como las ruedas o los frenos durante el uso de la silla de ruedas
- Se recuerda que la temperatura de la superficie de la silla de ruedas puede aumentar si queda expuesta a fuentes de calor externas, como la luz solar

## 11. MODO DE USO

**Nota:** Consultar las advertencias generales en este manual de instrucciones.



### ¡ATENCIÓN!

- Subir y bajar solos de la silla de ruedas es una acción potencialmente peligrosa: hacerlo sólo si se cuenta con las condiciones físicas necesarias y teniendo mucho cuidado
- No apoyarse sobre las partes amovibles; dar preferencia al bastidor del asiento

**• NO CARGAR TODO EL PESO DEL CUERPO SOBRE LOS REPOSAPIÉS DURANTE LA SUBIDA O LA BAJADA DE LA SILLA DE RUEDAS: ¡PELIGRO DE VUELCO!**

### 11.1 Subirse a la silla de ruedas

1. Acercar la silla de ruedas al cuerpo todo lo posible
2. Bloquear los frenos de las ruedas traseras; para facilitar al máximo la subida a la silla de ruedas, se recomienda quitar el brazo del lado donde se realicen estas operaciones
3. Apoyarse en la estructura del bastidor haciendo fuerza sobre los brazos, y bajar lentamente hacia el asiento

### 11.2 Bajarse de la silla de ruedas

1. Acercarse todo lo posible a otro asiento donde sentarse
2. Bloquear los frenos de las ruedas traseras; para facilitar al máximo la bajada de la silla de ruedas se recomienda quitar el brazo de la silla del lado donde se realicen estas operaciones
3. Apoyar los brazos en el bastidor del otro asiento y levantarse para pasar lentamente al otro asiento

### 11.3 Escalones y desniveles (consejos para afrontarlos lo mejor posible estando solos)



### ¡ATENCIÓN!

Estas técnicas son válidas sólo para usuarios expertos de sillas de ruedas. En todos los otros casos, se recomienda hacerse ayudar por un asistente.

**SUBIR**

Ponerse al borde de la acera o del escalón a superar.

Equilibrar la silla sobre las ruedas traseras para levantar las ruedas delanteras lo necesario y apoyarlas sobre el obstáculo a superar. Inclinar el busto hacia delante y empujar enérgicamente hacia delante el pasamano que se encuentra sobre las ruedas traseras. Seguir empujando hasta que las ruedas traseras se suban al obstáculo.

**BAJAR**

Para descender del desnivel, seguir el procedimiento inverso. Ubicarse con la parte trasera de la silla de ruedas delante del desnivel a superar, sujetar con fuerza el pasamano de las ruedas traseras y bajar lentamente el escalón o el obstáculo; luego equilibrar la silla de ruedas sobre las ruedas traseras para levantar ligeramente las ruedas delanteras y terminar delicadamente la bajada.

**¡ATENCIÓN!**

Se recomienda no utilizar esta técnica en presencia de desniveles superiores a 10 cm.

**11.4 Uso de los brazos**

Los brazos pueden ser sólo abatibles, sólo amovibles o bien abatibles y amovibles:

**Replegar el brazo** - Esta función resulta muy cómoda para subir o bajar de la silla de ruedas. Para replegar el brazo es suficiente presionar la palanca de desenganche delantera y girarlo hacia la parte posterior.

**11.5 Uso de las ruedas con auto-empuje**

Las ruedas traseras grandes (60 cm) sirven para conducir la silla de ruedas con auto-empuje. Empuñar el pasamano que se encuentra sobre la rueda y empujar en la dirección deseada.

**11.6 Uso de las ruedas pequeñas**

Las ruedas traseras pequeñas (30 cm) están destinadas a la conducción de la silla de ruedas con el auxilio de un operador, mediante las empuñaduras de los asideros posteriores de la silla de ruedas.

**11.7 Uso de las ruedas pequeñas para pasos angostos (de serie en los modelos con desenganche rápido)**

Este tipo de rueda sirve exclusivamente para permitir un desplazamiento breve de la silla de ruedas, para el paso por lugares muy angostos (por ejemplo, las puertas de un ascensor). Para utilizar estas ruedas es necesario levantar la silla de ruedas, extraer las ruedas traseras, empujar la silla de ruedas haciéndola apoyar sobre las ruedas pequeñas y luego volver a colocar las ruedas traseras.

**11.8 Transporte en medios de desplazamiento**

La silla de ruedas está diseñada para ser fácilmente transportada. Una vez desmontados los estribos y los brazos, es posible cerrarla y guardarla cómodamente, por ejemplo, en el maletero de un vehículo. Si no cabe en el maletero, ponerla sobre el asiento trasero, de manera que quede estable y no pueda resbalar y volcarse. En lo posible, bloquear la silla de ruedas con el cinturón de seguridad del vehículo.

## 12. MANTENIMIENTO

Los productos de la línea **ARDEA ONE** fabricados por Moretti S.p.A. que se introducen en el comercio han sido cuidadosamente controlados y provistos de marca CE. Para la seguridad del paciente y del médico se recomienda hacer controlar la idoneidad del producto al fabricante o a un laboratorio autorizado al menos cada 2 años. En caso de reparación, utilizar sólo repuestos y accesorios originales. Antes de utilizar el producto, realizar todas las verificaciones y controles sugeridos en el apartado "ANTES DE CADA USO" de este manual de instrucciones. Las sillas de ruedas **ARDEA ONE** requieren periódicamente unos pocos controles elementales de mantenimiento:

capacidad de frenado	mensual
limpieza del asiento	según la necesidad

## 13. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

### 13.1 Limpieza del revestimiento y el relleno

El revestimiento y el relleno son de nailon. Se pueden limpiar con agua y jabón neutro.

### 13.2 Limpieza del bastidor y de las partes metálicas

Para el bastidor y las partes metálicas se puede utilizar agua y jabón neutro. Secar con un paño suave para no rayar la pintura.

### 13.3 Limpieza de las ruedas y de los frenos

Las ruedas se pueden limpiar con agua y jabón neutro. Prestar mucha atención al secado: podría ser muy peligroso utilizar la silla de ruedas con las ruedas todavía húmedas.

### 13.4 Desinfección

Si es necesario, desinfectar el producto con un detergente desinfectante común.

**Nota** Evitar absolutamente utilizar productos ácidos, alcalinos o solventes como acetona o diluyente.

## 14. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

No eliminar el producto junto con los desechos sólidos urbanos. Para la eliminación del producto, entregarlo en una isla ecológica municipal en vistas del posterior reciclado de los materiales.

## 15. REPUESTOS Y ACCESORIOS

Para conseguir repuestos y accesorios, consultar exclusivamente el catálogo general Moretti.

## 16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### 16.1 Medidas

#### MEDIDAS Y PESOS

Medidas en cm



CP100B-38								38		56						
CP100B-40								40		58						
CP100B-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43	43	60,5	26	17,5	60	20	-	120
CP100B-45								45		63						
CP100B-46								46		64						
CP100B-48								48		65						
CP100R-40								40		58						
CP100R-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43	43	61	26,5	17,5	60	20	-	120
CP100R-45								45		63						
CP100R-48								48		65						
CP103R-40								40		58						
CP103R-43								43		60,5						
CP103R-45	103	85	40	91	75	50	42-56	45	43	63	26,5	19	60	20	-	130
CP103R-48								48		66						
CP103R-50								50		68						
CP104-40								40		58						
CP104-43								43		60,5						
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-	130
CP104-48								48		66						
CP104-50								50		68						
CP105-40								40		58						
CP105-43								43		60,5						
CP105-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43	64	26,5	19	60	20	-	130
CP105-48								48		66						
CP105-50								50		68						

Medidas en cm



CP500B-40								40		58						
CP500B-43								43		61						
CP500B-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	-	120
CP500B-46								46		64						
CP500B-48								48		65						
CP500R-40								40		58						
CP500R-43	103	75	43	91	73	50	42-56	43	43	61	26,5	15	30	20	-	120
CP500R-45								45		63						
CP505-40								40		58						
CP505-43								43		61						
CP505-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43	63	26	15	30	20	-	130
CP505-48								48		65						
CP505-50								50		67						

\*Las medidas pueden variar en ± 0,5 cm

## 16.2 Especificaciones técnicas

- Bastidor de acero
- Capacidad máx. CP100-xx, CP500-xx: 120 kg
- Capacidad máx. CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx: 130 kg
- Ruedas delanteras de PVC diámetro 20 cm en CP100-xx
- Ruedas delanteras de PU diámetro 20 cm en CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx
- Ruedas traseras de PU diámetro 60 cm en CP100-xx, CP103R-xx, CP104-xx
- Ruedas traseras de PU diámetro 30 cm en CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx
- Asiento, respaldo y revestimiento acolchado de brazos de nailon
- Resistencia al encendido: Los materiales utilizados para el revestimiento y el tapizado han sido puestos a prueba con métodos especificados en la norma EN1021-1/2
- Normas de referencia: EN 12183
- Temperatura del ambiente operativo: -20 C° / + 40 C°
- Conservación recomendada: Conservar en un lugar fresco y seco y siempre lejos de fuentes de calor directas como la luz solar. (temperatura recomendada entre +10 C° / + 40 C°)

## 17. GARANTÍA

Todos los productos Moretti tienen una garantía de 2 años desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material, sin perjuicio de eventuales exclusiones y de las limitaciones especificadas a continuación. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no se respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no se hace responsable de daños, lesiones personales u otras consecuencias derivadas de errores de instalación y de un uso del producto no conforme a las instrucciones de los manuales de instalación, montaje y uso. Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o defectos en las condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por la alimentación eléctrica (si está prevista), uso de piezas no suministradas por Moretti, incumplimiento de las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños durante el envío (diferente del envío original de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas a deterioro si el daño es causado por el uso normal del producto.

### 17.1 Reparaciones

**Reparación en garantía:** Si un producto Moretti presenta defectos de material o de fabricación durante el período de garantía, Moretti evaluará con el cliente si el defecto del producto está cubierto por la garantía. Moretti a su discreción puede sustituir o reparar el artículo en garantía en la dirección de un revendedor Moretti especificado o en su propia sede. Los costes de mano de obra para la reparación del producto pueden estar a cargo de Moretti si se determina que la reparación está cubierta por la garantía. Una reparación o sustitución no renueva ni prorroga la garantía.

**Reparación de un producto no cubierto por la garantía:** Un producto no cubierto por la garantía podrá ser devuelto para la reparación sólo con la autorización previa del servicio Clientes de Moretti. Los costes de mano de obra y envío relativos a una reparación no cubierta por la garantía estarán totalmente a cargo del cliente o del revendedor. Las reparaciones de productos no cubiertos por la garantía tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del producto reparado.

**Productos no defectuosos:** Tras la evaluación y la prueba de un producto devuelto, Moretti notificará al cliente en el caso de que el producto no resulte defectuoso. El producto será devuelto al cliente y estarán a su cargo los costes de devolución.

## 17.2 Repuestos

Los repuestos originales Moretti tienen una garantía de 6 (seis) meses desde la fecha de entrega del repuesto.

## 17.3 Cláusulas exonerativas

Más allá de las especificaciones de esta garantía y dentro de los límites de ley, Moretti no ofrece ninguna otra declaración, garantía o condición expresa o implícita con respecto a la aptitud para la comercialización, la idoneidad para fines particulares, la no-violación y la no-interferencia. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti no pueda presentar interrupciones o errores. La duración de eventuales garantías implícitas que puedan ser impuestas por normas de ley se limita al período de garantía conforme a los límites de ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones de la duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos en relación con productos para los consumidores. En dichos estados y países, algunas exclusiones o limitaciones de esta garantía podrían no aplicarse al usuario. La presente garantía está sujeta a variaciones sin aviso previo.